
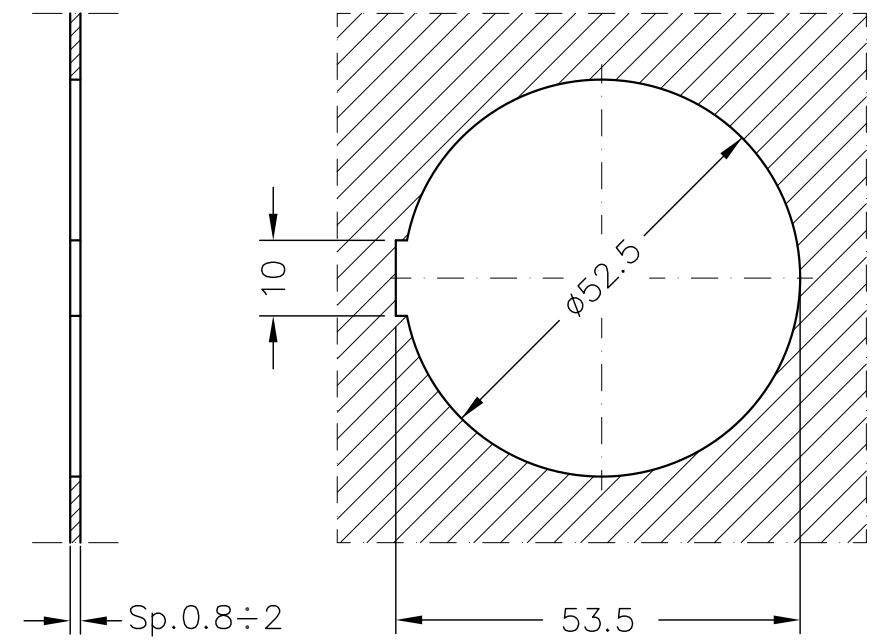
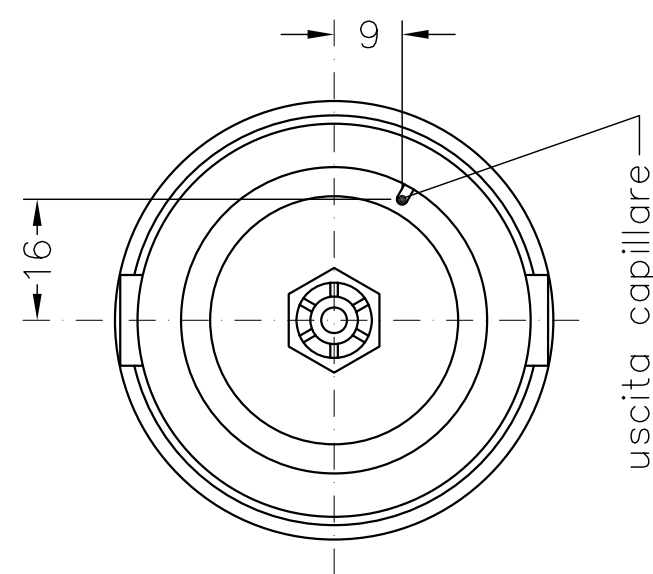
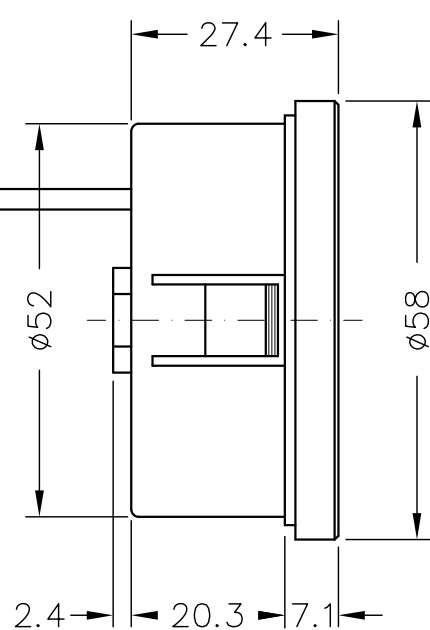
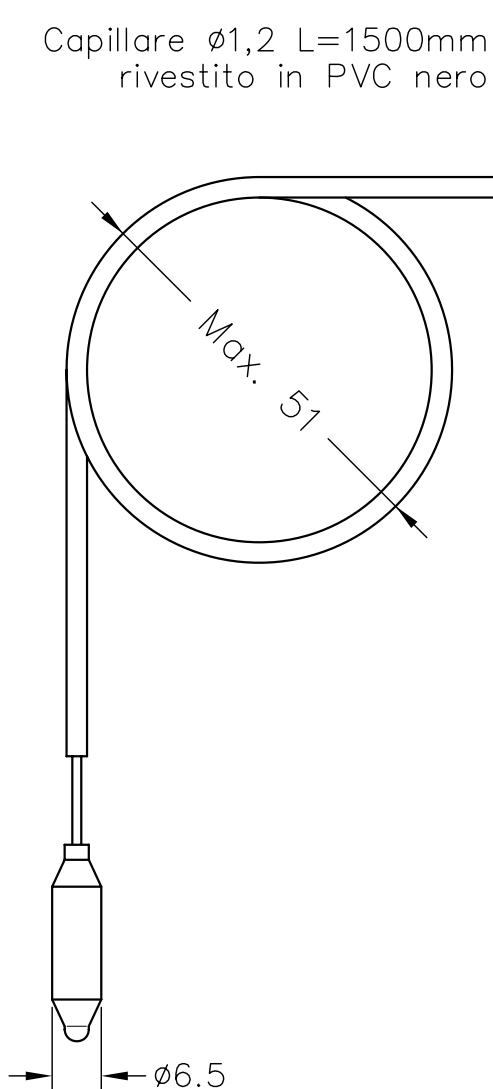


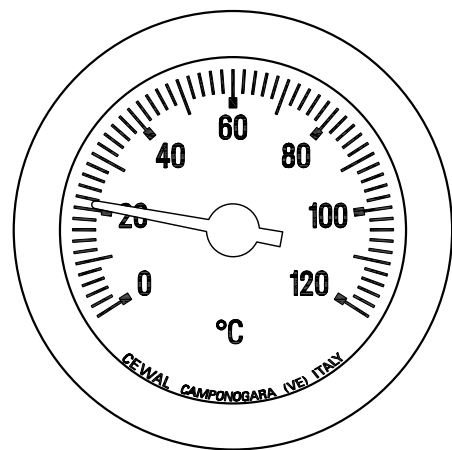

DATI TECNICI	
CAMPO DI LAVORO	0°C / 120°C
CASSA	PIBITER NERO
TRASPARENTE	ALTUGLAS (METACRILATO)
QUADRANTE	ALLUMINIO FONDO NERO GRAFICA BIANCA
INDICE	NYLON BIANCO
GHIERA	PIBITER NERO
TEMP.MAX.SOPPORTATA DAL CORPO	70°C
TARATURA	60°C ± 2°C
CONTROLLO	30°C ± 3°C / 80°C ± 3°C
RAGGIO MINIMO CURVATURA CAPILLARE	5 mm

2	18/10/04	Modificata struttura del bulbo mantenendo invariato il ø esterno e il volume utile	B	gd	AS
1	21/05/98	Variata struttura del termometro da ingranaggi a senza ingranaggi	A	gd	AS
INDICE	DATA	CAUSA DELLA MODIFICA		INDICE	DISEGN. APPROV.
MATERIALE:		TRATTAMENTO:	DISEGNATO: gd	APPROVATO: AS	
TERMOMETRO ø52 120°C 1,5 Mt. PVC			DIS. N°	91312110	2
CASSA NERA GHIERA NERA FN/NB. "CEWAL"			SCALA	1:1	DATA: 11/09/96
cewal S.p.A.			TOLLERANZE GENERALI		xxx = QUOTE CRITICHE
30010 CAMPOGARA (VENEZIA)			Lavorati Stampati		DA TENERE SOTTO CONTROLLO
via Gramsci N°48, tel.041/462155			Angoli ±30° Angoli ±2°		DURANTE LA PRODUZIONE
telefax.041/4174282			Quote 0-18±0.15 Spessore ±10%		xx = QUOTE IMPORTANTI
			18-80±0.25>80±0.4 Lunghezza o ø 0.5%		Proprietà riservata a termini di legge. Questo disegno non può essere ceduto a terzi senza la ns preventiva autorizzazione.